

<16-02>
2016年1月

先生各位

「抗Sm抗体（FEIA法）」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、標記検査項目におきまして、同一メーカーが販売する新試薬に変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目：

・抗Sm抗体(FEIA法)

[項目コード:2227]

■変更内容：

変更箇所	新	現
基準値	7 U/mL 未満 (-)	5 U/mL 未満 (-)
判定基準	(-) : 7 未満 (±) : 7~10 (+) : 11 以上	(-) : 5 未満 (±) : 5~10 (+) : 11 以上
報告上限値	480 U/mL 以上	120 U/mL 以上

■変更実施日：

2016年 2月 29日(月) 受付分より


以上

※裏面もご覧ください。

■抗Sm抗体(FEIA法)

SLE(全身性エリテマトーデス)に対する感度および特異性が向上した改良試薬に変更させていただきます。この変更に伴い、基準値・判定基準および報告上限値を変更いたします。

●新法と現法の比較

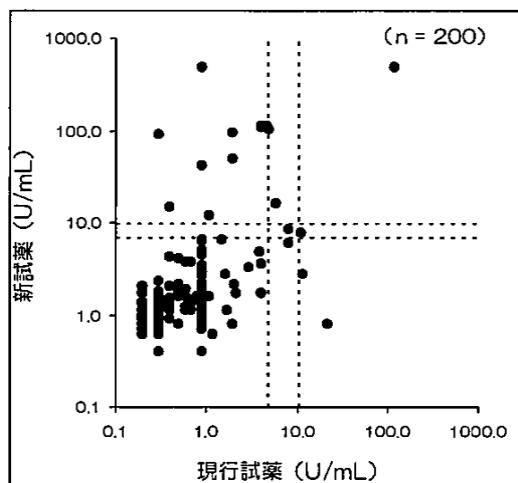

新試薬	判定一致率 91.50%	現行試薬			
		(-)	(±)	(+)	合計
	(-)	182	1	2	185
	(±)	0	1	1	2
	(+)	10	2	1	13
	合計	192	4	4	200