

< 26-12 >

2026年6月

先生各位

「プロトロンビン時間 (PT)」

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、プロトロンビン時間 (PT) の測定試薬を変更させていただくに伴い、基準範囲を新たに設定いたします。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更対象項目:

プロトロンビン時間(PT)

[項目コード:555]

■変更内容:

		新	現
測定試薬		レボヘムPT	デイドイノビン
基準値/単位	測定値	9.6 ~ 12.6 / 秒	—
	活性値	75 ~ 135 / %	70 ~ 140 / %
	INR	0.87 ~ 1.16	—

※検査方法及び報告内容等に変更はございません。




■変更実施日:

2026年 8月 3日 (月) 受付分より

以上


※ 裏面をご覧ください。

＜新試薬と現試薬の比較＞

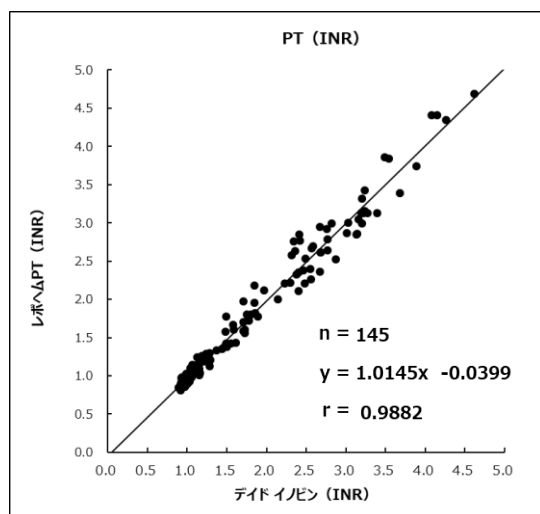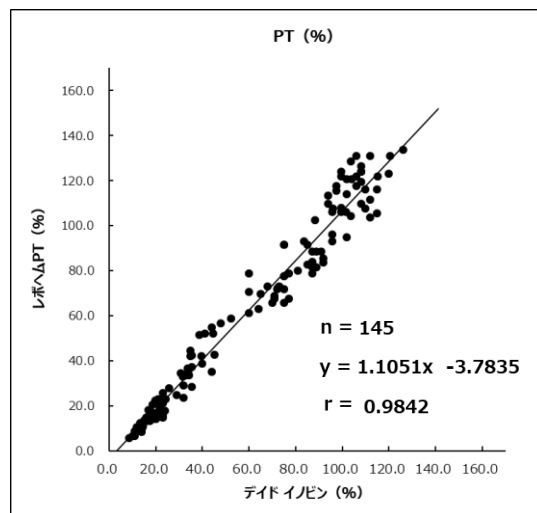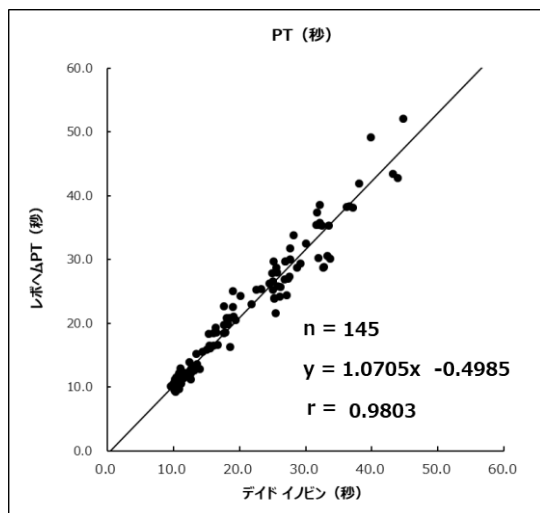


<基準範囲の設定について>

基準範囲：測定値 9.6～12.6秒

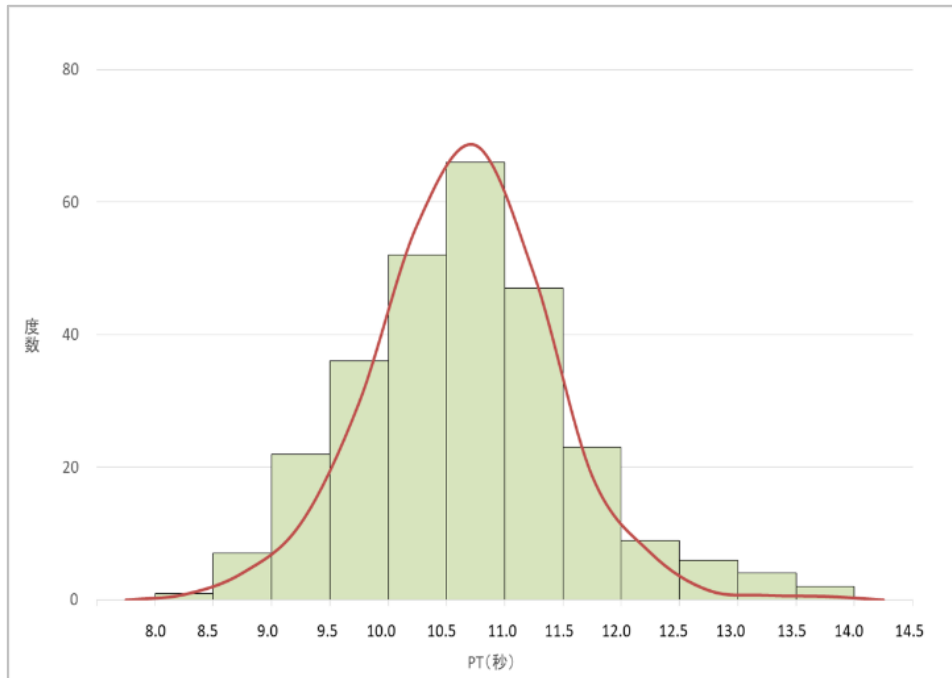


(※健常者ボランティア280検体を使用)

基準範囲：活性値 75～135%

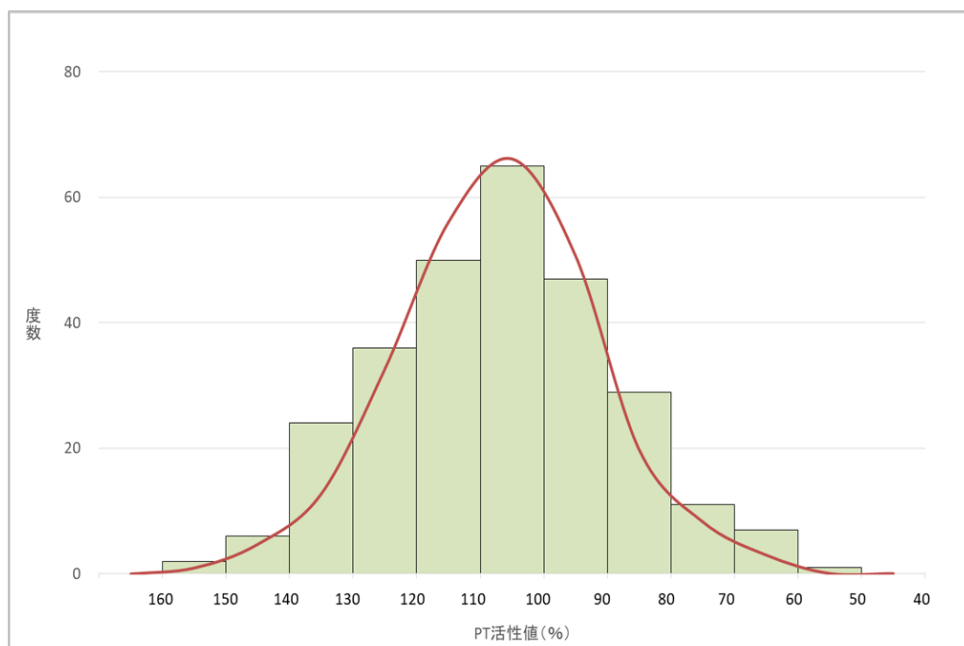

(※健常者ボランティア280検体を使用)

基準範囲 : INR 0.87~1.16

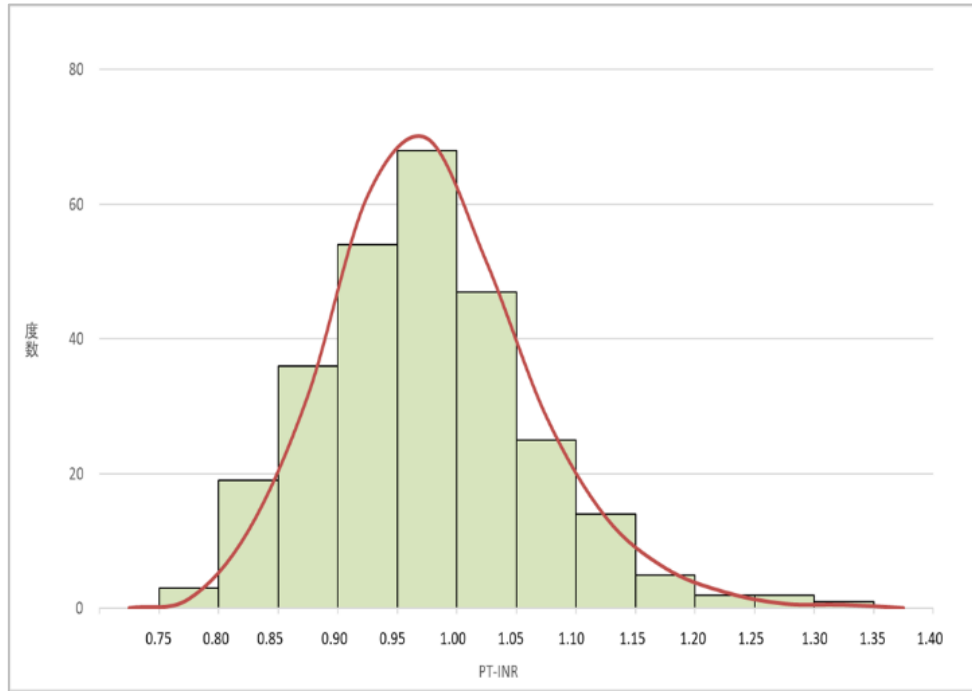

(※健康者ボランティア280検体を使用)